

## Wärmeschrank für THERM-Packungen Typ WT 3050-8 Teile-Nr. AF6570

Bestehend aus:

Gerät aus Edelstahl mit abklappbarer doppelwandiger Fronttüre, allseitig isoliert. Aussengehäuse aus mustergewalztem Edelstahlblech als Schweißkonstruktion.

8 Einschübe mit 6 Aufnahmeblechen. 1 Ein- und Ausschalter mit Kontrolleuchte. 1 Temperaturregler (30 - 80°C).

1 Umluftgebläse 45 W, 2000 U/Min. Heizleistung 1800 W. Regelgenauigkeit +/- 1,5°C. Alle Bauteile und Regelorgane sind von vorn servicefreundlich zugänglich.

Geräteanschlusskabel (ca. 1,5 m lang) mit Schuko-Stecker.

### Fassungsvermögen

Max. 8 THERM-Packungen der Größe 30 x 50 cm oder  
max. 4 THERM-Packungen der Größe 50 x 70 cm.

(große Therm-Packungen auf die Hälfte zusammengelegt).

### Technische Daten

Maße (Breite x Höhe x Tiefe): ca. 800 x 480 x 460 mm.

Elektro-Anschluss: 230 V, 50 Hz, 1845 W.

Dieses Gerät kann auf jede Arbeitsplatte mit einer Mindestdiefe von 500 mm gestellt werden.

### Option

Teile-Nr. TF0343

Zusätzliches Aufnahmeblech (550 x 330 mm).



*Untergestell (ZF6510) nicht im Lieferumfang von AF6570 enthalten.*

**6**

## Untergestell für Wärmeträger- Erwärmungsgeräte Typ APS 18 U für APS 18 N und WT 3050-8 Teile-Nr. ZF6510

Stahlrohr-Schweißkonstruktion weiß kunststoffbeschichtet mit vier Lenkrollen, zwei davon mit Feststellern. 1 Ablageboden aus Edelstahlblech, darüber 2 Ablagegitter aus Edelstahl-Rundmaterial.

Maße (Breite x Höhe x Tiefe): ca. 800 x 690 x 460 mm.

### Optionen

Siehe Übersicht Blatt 19.06.01 und 19.06.02 Zubehör und Sonderausstattung.


Technische Änderungen vorbehalten – Abbildungen können kostenpflichtige Optionen enthalten

**Trautwein GmbH, 79312 Emmendingen**

Tel.: 07641/4677-30 Fax: 07641/4677-70

Internet: <http://www.trautwein-gmbh.com>

19.06.09

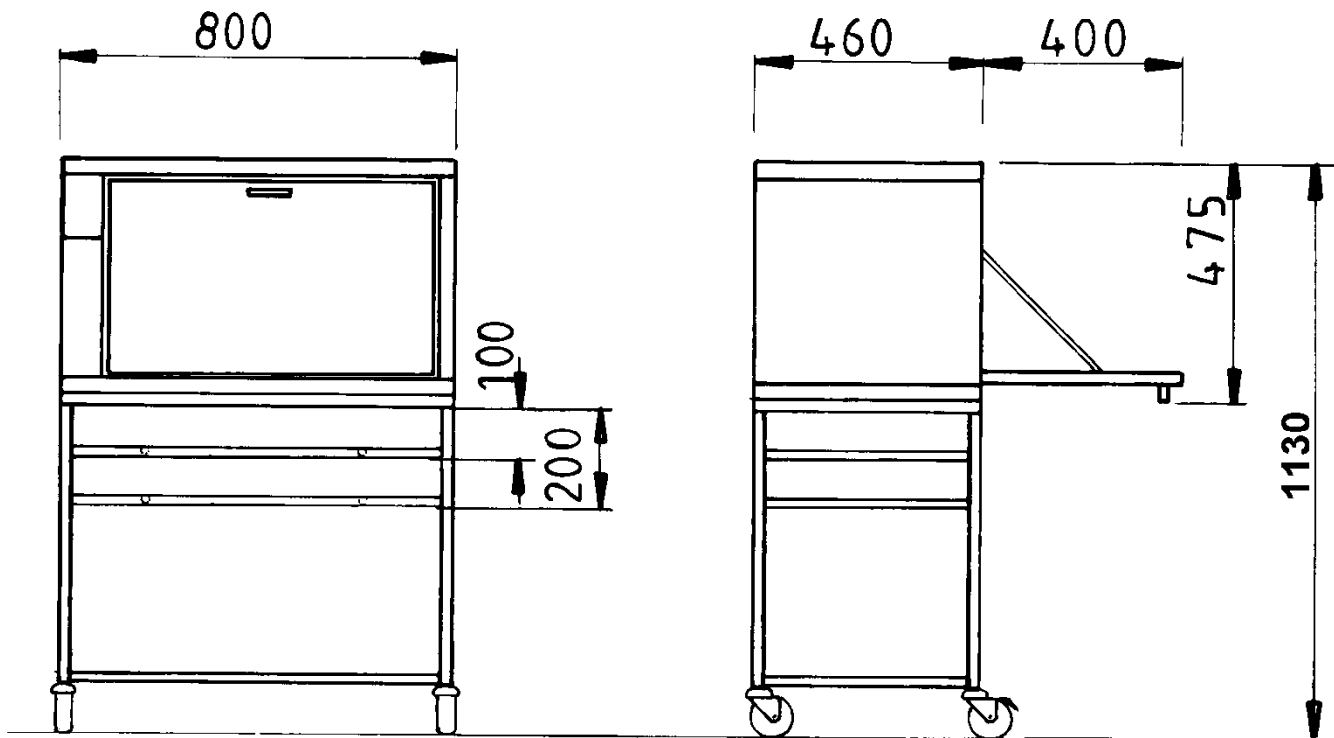

Wärmeträger-Erwärmungsgerät  
Typ WT 3050-8  
Teile-Nr. AF6570

Untergestell  
Typ APS 18 U  
Teile-Nr. ZF6510

**Bauseitige Vorbereitungen**

- A. Steckdose 230 V, 50 Hz, 1845 W.  
Stromzuführung über Sicherung (15 A).  
Bei Aufstellung in medizinisch genutzten Räumen  
FI-Schutzschalter vorsehen (30 mA).  
Elektroinstallation nach DIN IEC/VDE

Technische Änderungen vorbehalten – Abbildungen können kostenpflichtige Optionen enthalten

19.06.09

**Trautwein GmbH, 79312 Emmendingen**

Tel.: 07641/4677-30 Fax: 07641/4677-70  
Internet: <http://www.trautwein-gmbh.com>